


Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
ZAGREB, Mirogojska 8

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Stropni stativi
Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
dana 10.10.2025. godine u 13:00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Stropni stativi)"

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
	Stropni sustav za dva kreveta u izolacijskim jedinicama			
I	U 14 bolesničkih soba-izolacijskim jedinicama, predviđen je "stropni sustav" sastavljen od nosača stropnog kanala-grede i tri vertikalna nosača opreme - regala. U jednoj bolesničko sobi (radi promjene gabarita prostorije) predviđen je isti stropni sustav ali s 2 vertikalna nosača opreme-regala. 14 KPL	SVI		
	Opis sustava za 14 bolesničkih soba:			
1.	Podkonstrukcija za ugradnju sustava na strop (za savladavanje visine iznad spušenog stropa od ab.ploče). Isporuka odmah -rad izvodi izvođač radova po nalogu opremača			EUROTRENK: Traži se informacija o razmaku između spušenog stropa i stropne konstrukcije
2.	Stropni vodoravni nosač opskrbnih stupova ("greda") minimalne duljine L = 440 cm, fiksirana s opskrbnim stupovima na podkonstrukciju, kroz koje se provode instalacije za opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima te za smještaj medicinske opreme	SVI		
3.	Predvidjeti najmanje 4 stupa promjera od 100 mm do 145 mm, sa spojnica za plinove i električnu instalaciju koja se provodi unutar grede	SVI		
4.	Obvezno predvidjeti 2 indirektna LED svjetla, smještena s gornje strane grede (za svaki krevet). Paljenje svjetla na bočnim stupovima ili kod ulaza u bolesničku sobu-odluka korisnika.	SVI		
5.	2 direktna LED svjetla za pregled pacijenata, smješteno s donje strane grede. za svaki krevet. Paljenje svjetla na bočnim stupovima	SVI		
6.	POMIČNI OPSKRBNII STUPOVI-bočni			
6.1.	2 pomična opskrbna stupa-"regala" (lijevi i desni), smješteni na zglobnoj ruci duljine minimalno 40 cm, pozicionirani na krajnjim rubovima vodoravne grede, s ugrađenim pneumatskim kočnicama (2 komada) s mogućnosti pomicanja lijevo-desno najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnica	OSTALI		EUROTRENK: Može ponuditi dvostruku zakretnu zglobnu ruku
6.2.	Visina stupa minimalno 100 cm	SVI		
6.3.	Nosivost stupa minimalno 100 kg	SVI		
6.4.	Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe	SVI		
6.5.	Predvidjeti montažu dodatne opreme na minimalno tri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini	SVI		
6.6.	Na minimalno tri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)	SVI		
6.7.	Električne instalacije: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 4x Mrežna utičnica RJ-45 - 1x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI	SVI		
6.8.	Ugrađene utičnice medicinskih plinova DIN: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar - 1 x Vakum	SVI		
6.9.	Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom	SVI		
6.10.	Predvidjeti najmanje dva slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre	SVI		
6.11.	Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova, duljine minimalno 50 cm, sa savitljivim poklopcem.	SVI		
6.12.	Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10x25 mm (EU standard)	SVI		
6.13.	Jedna ladica dimenzije minimalno 40x35 cm (širina x dubina), tiho zatvaranje	SVI		

PON:

1.  K.D. Weid
2.  Kuto
3.  dulo

 Brki

SRNA:

1. 
2. 

6.14.	Infuzijski stalak podesive visine (minimalno od 100 do 180 cm) za više boca postavljen na dvostruku zglobovnu ruku (minimalne duljine 20 cm + 20 cm), s kočnicom. Nosivost minimalno 20 kg. (1 komad)	SVI		
6.15.	Dvostruka zglobovna ruka (za postavu ekrana/monitora, minimalne duljine 20 cm + 20 cm), s kočnicom i utorom/kanalom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
6.16.	Standardne šine presjeka 10x25 mm (EU standard), duljine minimalno 40 cm, smještene na bočnoj i na prednjoj strani opskrbnog stupa. Nosivost šine minimalno 20 kg. (3 komada)	SVI		
6.18.	Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinske opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativ. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
6.19.	Pregledna svjetiljka, šinska (1 komad) s LED izvorom svjetla od minimalno 30.000 luksa, s mogućnosti podešavanja intenziteta svjetla	SVI		
7.	POMIČNI OPSKRBN STUP-srednji) 1 KOM			
7.1.	Pomični opskrbni stup (srednji) s ugrađenim pneumatskim kočnicama s mogućnosti pomicanja lijevo-desno najmanje 50 cm od točke montaže. Obavezna kontrola kočnice stupa.	SVI		
7.2.	Visina opskrbnog stupa minimalno 120 cm	SVI		
7.3.	Nosivost opskrbnog stupa minimalno 120 kg	SVI		
7.4.	Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe	SVI		
7.5.	Predvidjeti montažu dodatne opreme na minimalno tri brida opskrbnog stupa, po cijeloj dužini	SVI		
7.6.	Na minimalno tri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)	SVI		
7.7.	Električne instalacije: - 20x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 20x Izjednačenje potencijala - 8x Mrežna utičnica RJ-45 - 2x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI - 1x trofazna utičnica za RTG	SVI		Trofazna utičnica za RTG projektnom dokumentacijom će se prebaciti na zid. NORMAN GRUPA: maksimalno šest utičnica na jedan strujni krug.
7.8.	Ugrađene utičnice medicinskih plinova DIN: - 4x Kisik - 4x Zrak 5 bar	SVI		
7.9.	Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom	SVI		
7.10.	Predvidjeti najmanje četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre	SVI		
7.11.	Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova, duljine najmanje 75 cm, sa savitljivim poklopcem.	SVI		
7.12.	Jedna polica dimenzija minimalno 40 cmx45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10 mmx25 mm (EU standard)	SVI		
7.13.	Jedna ladica dimenzije minimalno 40 cmx35cm (širina x dubina), tiho zatvaranje	SVI		
7.14.	Infuzijski stalak podesive visine (minimalno od 100 cm do 180 cm) za više boca postavljen na dvostruku zglobovnu ruku (minimalne duljine 20 cm + 20 cm), s kočnicom. Nosivost minimalno 20 kg. (1 komad)	SVI		
7.15.	Dvostruka zglobovna ruka (za postavu ekrana/monitora, minimalne duljine 20 cm + 20 cm), s kočnicom i utorom/kanalom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
7.16.	Standardna šina presjeka 10 mmx25 mm (EU standard), duljine minimalno 40 cm, smještene na bočnoj i na prednjoj strani opskrbnog stupa. Nosivost šine minimalno 20 kg. (2 komada)	SVI		
7.17.	Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinske opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativ. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
7.18.	Pregledna svjetiljka, šinska (1 komad) s LED izvorom svjetla od minimalno 30.000 luksa, s mogućnosti podešavanja intenziteta svjetla	SVI		
8.	Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja središnjeg i pomoćnih opskrbnih stupova sa stropnim vodoravnim nosačem opskrbnih stupova.	SVI		
II.	Stropni sustav za jedan krevet izolacijske jedinice 1 KOM			
1.	Podkonstrukcija za ugradnju sustava na strop (za savladavanje visine iznad spuštenog stropa od ab.ploče). Isporuka odmah -rad izvodi izvođač radova po nalogu opremača	SVI		
2.	Stropni vodoravni nosač opskrbnih stupova ("greda") minimalne duljine L = 350 cm, fiksiran na podkonstrukciju, s opskrbnim stupovima kroz koje se provode instalacije za opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima te za smještaj medicinske opreme	SVI		
3.	Predvidjeti najmanje 2 stupa promjera od 100 mm do 145 mm, sa spojnica za plinove i električnu instalaciju koja se provodi unutar grede	SVI		

Psk:

1.

2.

3.

1.

2.

STRUKA:

4.	Obvezno predvidjeti 2 indirektna LED svjetla, smještena s gornje strane grede. Paljenje svjetla na bočnim stupovima ili kod ulaza u bolesničku sobu odluka korisnika.	SVI		
5.	1 direktno LED svjetlo za pregled pacijenata smješteno s donje strane grede. Paljenje svjetla na bočnim stupovima	SVI		
6.	POMIČNI OPSKRBNI STUP- lijevi			
6.1.	1 pomični opskrbeni stup-"regal" (lijevi), smješteni na zglobojnoj ruci duljine minimalno 40 cm, pozicioniran na lijevoj strani vodoravne grede, s ugrađenom pneumatskom kočnicom s mogućnosti pomicanja lijevo-desno najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnica			EUROTRENK: Može ponuditi dvostruku zakretnu zglobojnu ruku
6.2.	Visina stupa minimalno 100 cm	SVI		
6.3.	Nosivost stupa minimalno 100 kg	SVI		
6.4.	Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe	SVI		
6.5.	Predvidjeti montažu dodatne opreme na minimalno tri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini	SVI		
6.6.	Na minimalno tri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)	SVI		
6.7.	Električne instalacije: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 4x Mrežna utičnica RJ-45 - 1x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI	SVI		
6.8.	Ugrađene utičnice medicinskih plinova DIN: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar - 1x Vakum	SVI		
6.9.	Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom	SVI		
6.10.	Predvidjeti najmanje dva slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre	SVI		
6.11.	Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova, duljine minimalno 50 cm, sa savitljivim poklopcem.	SVI		
6.12.	Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije	SVI		
6.13.	Jedna ladica dimenzije minimalno 40x35 (širina x dubina), tiho zatvaranje	SVI		
6.14.	Infuzijski stalak podesive visine (minimalno od 100 cm do 180 cm) za više boca postavljen na dvostruku zglobojnu ruku (minimalne duljine 20 cm + 20 cm), s kočnicom. Nosivost minimalno 20 kg. (1 komad)	SVI		
6.15.	Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinske opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativa. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
7.	POMIČNI OPSKRBNI STUP- desni			
7.1.	Pomični opskrbeni stup s ugrađenom pneumatskom kočnicom s mogućnosti pomicanja lijevo-desno bilo gdje na nosivoj gredi, najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnice stupa.	SVI		
7.2.	Visina opskrbnog stupa minimalno 100 cm	SVI		
7.3.	Nosivost opskrbnog stupa minimalno 100 kg	SVI		
7.4.	Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe	SVI		
7.5.	Predvidjeti montažu dodatne opreme na minimalno tri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini	SVI		
7.6.	Na minimalno tri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)	SVI		
7.7.	Električne instalacije: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 6x Mrežna utičnica RJ45 - 1x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI - 1x Trofazna utičnica za RTG			Trofazna utičnica za RTG projektnom dokumentacijom će se prebaciti na zid. NORMAN GRUPA: maksimalno šest utičnica na jedan strujni krug. Uz električne instalacije će se dodati koliko utičnica ide na agregat, a koliko na UPS uz oznake boja.
7.8.	Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar	SVI		
7.9.	Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom	SVI		
7.10.	Predvidjeti najmanje četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre	SVI		

PON:

1.

2.

3.


1.

2.

STRUKA:

7.11.	Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova, duljine najmanje 75 cm, sa savitljivim poklopcem.	SVI		
7.12.	Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10x25 mm	SVI		
7.13.	Jedna ladica dimenzije minimalno 40x35 (širina x dubina), tiho zatvaranje	SVI		
7.14.	Dvostruka zglobna ruka (za postavu ekrana/monitora, minimalne duljine 20 cm + 20 cm), s kočnicom i utorom/kanalom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
7.15.	Standardna šina presjeka 10 mm x25 mm (EU standard), duljine minimalno 40 cm, smještena na bočnoj strani opskrbnog stupa. Nosivost šine minimalno 20 kg.	SVI		
7.16.	Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinske opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativu Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)	SVI		
7.17.	Pregledna svjetiljka, šinska (1 komad) s LED izvorom svjetla od minimalno 30.000 luksa, s mogućnosti podešavanja intenziteta svjetla	SVI		
8.	Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja opskrbnih stupova sa stropnim vodoravnim nosačem opskrbnih stupova. Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja	SVI		
III.	Stropni stativ s rukom za monitor			
	3 KOM			
	Stativi predviđeni u tri endoskopije			
1.	Podkonstrukcija za ugradnju sustava na strop (za savladavanje visine iznad spušenog stropa od ab.ploče). Isporuka odmah -rad izvodi izvođač radova po naputku opremača			EUROTRENK: Traži se informacija o razmaku između spušenog strupa i stropne konstrukcije
2.	Lijeva strana, opskrbna jedinica:			
2.1.	Dvostruka opskrbna zglobna ruka, minimalne duljine 150 cm, za prihvata opskrbnog stupa. Predvidjeti rotaciju najmanje 330°. Predvidjeti pneumatske kočnice za zlobove i opskrbni stup, s osiguranom kontrolom kočnica,	SVI		
2.2.	Stropni opskrbni stup za smještaj medicinske opreme s predviđenim priključcima za jaku i slabu struju i medicinskim plinovima (kisik, zrak i CO2). Minimalna neto nosivost opreme 150 kg (dopušteno odstupanje 10%). Najmanja visina opskrbnog stupa 125 cm.	SVI		
2.3.	Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe	SVI		
2.4.	Predvidjeti montažu dodatne opreme na minimalno tri brida opskrbnog stupa, po cijeloj dužini	SVI		
2.5.	Predvidjeti i dodatne šine/šinu za dodatnu opremu. Nosivost najmanje 20 kg.	SVI		
2.6.	Električne instalacije: - 12x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 6x Izjednačenje potencijala - 4x Mrežna utičnica RJ45 - 2x Utičnica za video-signal HD-SDI			NORMAN GRUPA: maksimalno šest utičnica na jedan strujni krug. Uz električne instalacije će se dodati koliko utičnica ide na agregat, a koliko na UPS uz oznake boja.
2.7.	Instalacije medicinskih plinova DIN: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar - 1x CO ₂ (samo u 2 stativa: gastroskopijska i kolonoskopijska) - 1x AGSS (ukoliko će se primjenjivati anestezija s N2O-boca na aparatu))	SVI		
2.8.	Konstrukcija utičnica mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom	SVI		
2.9.	Predvidjeti najmanje dva slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre	SVI		
2.10.	Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova, duljine minimalno 50 cm, sa savitljivim poklopcem.	SVI		
2.11.	Četiri police (za postavu opreme) dimenzija minimalno 60 cm x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10 mm x 25 mm (EU standard)	SVI		
2.12.	Jedna ladica dimenzija minimalno 60 cm x 35 cm (širina x dubina), s automatom za tiho zatvaranje	SVI		
2.13.	Dvostruka opskrbna zglobna ruka, minimalne duljine 40 cm + 40 cm s rotacijskim zglobovima. Predvidjeti pneumatsku kočnicu za zlobove i opskrbni stup, s osiguranom kontrolom kočnica. U opskrbnom stupu predviđeno provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg.	SVI		
3.	Desna strana - nosač monitora i dodatne opreme			

POL:

1.  K. D. Vukić
2. 
3. 



1. 
2. 

STRUKT:

3.1.	Dvostruka opskrbrna zglobna ruka, minimalne duljine 40 cm + 40 cm s rotacijskim zglobovima. Predvidjeti pneumatsku kočnicu za zglobove i opskrbrni stup, s osiguranom kontrolom kočnica. U opskrbrnom stupu predviđeno provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg.			Postalo stavka 2.13
3.2.	Nosač monitora smješten na dvostrukoj zglobnoj ruci minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom > 300° i s podešavanjem visine minimalno 1200 mm. Predvidjeti mjesto za prihvat transformatora monitora. Predviđa se prihvat monitora 24-32" s adapterom			Provjeriti predviđa li se prihvat jednog ili dva monitora
3.3.	Ugrađen 12G HD-SDI kabel	SVI		
3.4.	Na zglobnoj ruci-nosaču monitora, montirati ručicu za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju	SVI		
3.5.	Horizontalna rotacija monitora od minimalno 340° kao i nagib monitora	SVI		
4	Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja	SVI		
IV.	Zidna nadkrevetna jedinica za bolesničku sobu, 1-2 kreveta 5 KOM			
1.	Zidna nadkrevetna jedinica za bolesničku sobu, za smještaj električnih i utičnica medicinskih plinova te rasvjete za jedan krevet, duljine 150 cm (dozvoljeno odstupanje 5%)	SVI		
2.	Materijal izrade: aluminij	SVI		
3.	Fizički odvojene plinske i električne instalacije.	SVI		
4.	Zaobljeni kutovi i mjesta spajanja zaštićena gumenim trakama koje omogućuju lako čišćenje i dezinfekciju	SVI		
5.	Indirektno LED svjetlo ugrađeno u gornjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, minimalno 5100 lumena, paljenje svjetla preko sklopke na kanalu.	SVI		
6.	Direktno LED svjetlo ugrađeno u donjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, minimalno 1600 lumena, paljenje svjetla preko sklopke na kanalu	SVI		
7.	Ugrađena medicinska šina (EU standard) u donjem dijelu nadkrevetne jedinice cijelom njenom duljinom, nosivost šine minimalno 5 kg/m			Predviđeno je na zidu.
8.	Električne instalacije: - 6 x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 2x Izjednačenje potencijala - 2x Mrežna utičnica RJ-45	SVI		
9.	Instalacije medicinskih plinova DIN: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar	SVI		
10.	Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom	SVI		
11.	Minimalno četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre	SVI		
12.	Dodatna zidna šina (EU standard) za montažu dužine 150 cm (dozvoljeno odstupanje 5%) ispod zidne nadkrevetne jedinice, na visini 100 cm od kote poda	SVI		
13.	Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja	SVI		
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: 3 mjeseca		SVI		
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. Stavka 6.19 - Mogućnost podešavanja boje svjetla, od 3500 K do 4700 K (Draeger), od 4000 K do 4500 K (EUROTRENK) Stavka 7.18 - Mogućnost podešavanja boje svjetla, od 3500 K do 4700 K (Draeger), od 4000 K do 4500 K (EUROTRENK) Stavka 7.17 (II) - Mogućnost podešavanja boje svjetla, od 3500 K do 4700 K (Draeger), od 4000 K do 4500 K (EUROTRENK)				
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od 10 radnih dana.				
4. Ostalo: 1.) Isporučitelj je u obvezi isporučiti i sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju i vratiti prostor u prvobitno stanje; 2) Uz SVU fiksnu opremu koja je predmet isporuke postoji obveza isporuke i „instalacijskog nacrta“ 3) Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.				

POU:

Dana 07.10.2025. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Stropni stativi)"

1.  K.D. Vulec
2. 
3. 



1. 
2. 

STRUKT:

Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Stropni stativi)"

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. Dräger Medical Croatia d.o.o., (Naziv proizvođača: Drägerwerk AG&Co.KGaA / Njemačka)

1.1. Hrvoje Krupski, direktor

1.2. Kristina Dumančić Vukić, prodajni inženjer

2. Eurotrenk d.o.o., (Naziv proizvođača: INMED, Poljska), Zoran Pintek

3. Norman Grupa d.o.o., (Naziv proizvođača: LM Medical, Italija), Ante Odak, direktor

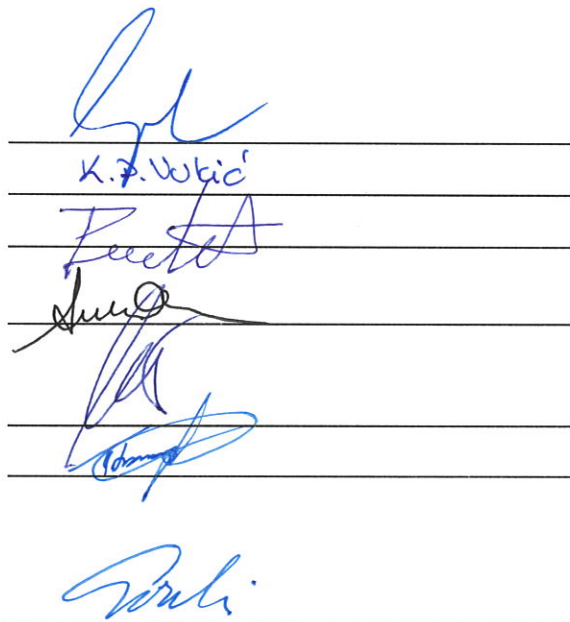
Ovlašteni predstavnici Klinike:

1. prof. dr. sc. Marko Kutleša, dr. med

2. Vitalii Pshevlotskyi, dipl.ing.

Ostali vanjski suradnici:

1. GORSKI d.o.o., Biserka Gorski d.i.a. (Stručnjak za arhitekturu bolnica (tehnolog), temeljem ugovora br. 05/2024 VV, Ur.br.: 01-1616-3-2024)



The block contains five horizontal lines for signatures. The first line has a signature in blue ink. The second line has a signature in blue ink with the name 'K. D. Vukić' written below it. The third line has a signature in blue ink. The fourth line has a signature in blue ink. The fifth line has a signature in blue ink.